График ухода и очистки для стоматологических установок C2⁺ – C5⁺, M1⁺

Постоянно обновляющийся список допущенных средств для ухода, очистки и дезинфекции можно получить в разделе REF 59 70 905 на домашней странице фирмы Sirona в Интернете: ⇨ www.sirona.com

После каждого пациента

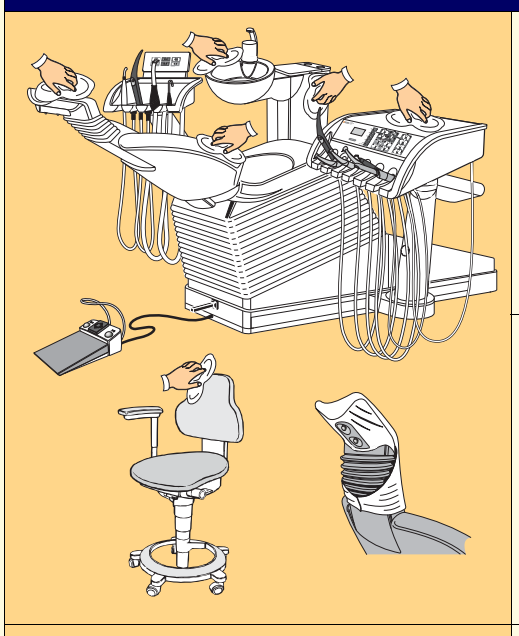

Продезинфицировать и очистить поверхности и обивку

⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***
Используйте только средства для очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Sirona!

Чехол на подголовник (5 штук) для электроприводного подголовника:
$C2^+$ – $C5^+$, $M1^+$ одноразовый:
Заказной № 58 72 820
$C2^+$ – $C5^+$, $M1^+$ стирающийся:
Заказной № 59 05 588

Очистить плевательницу

⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***
Используйте только средства для очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Sirona!

Запрещается использовать бытовые моющие и чистящие средства!

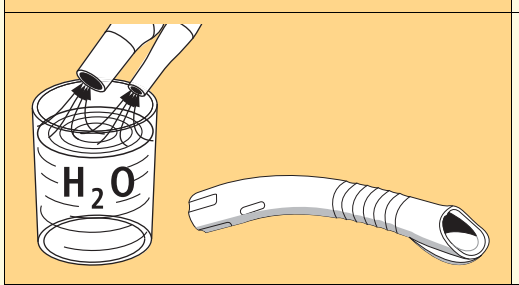

Отсососать большой стакан холодной воды, в частности
- после вмешательств, вызвавших кровотечения
- после использования H_2O_2
- при длительных лкчениях не реже, чем каждые 60 минут

Во избежание рефлюкса используйте всасывающую канюлю с отверстиями для дополнительного воздуха.

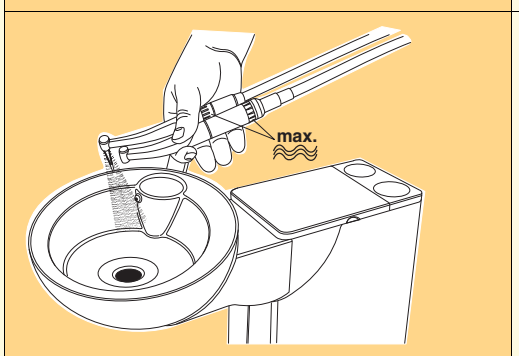

Функция Purge
Промыть водопроводящие каналы использованных инструмеентов блока врача.

Ежедневно

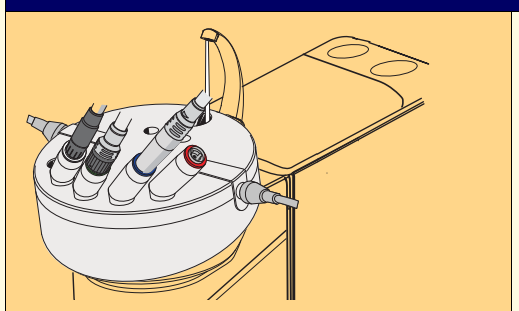

Функция Auto-Purge
(в стандартном варианте - для стоматологических установок с блоком врача, начиная с серийного № 75000)
- перед началом рабочего дня или в случае длительного простоя
- в конце рабочего дня

Автоматическая промывка водопроводящих инструментов блока врача, пистолета ассистента Sprayvit и наполнение стакана для полоскания рта.

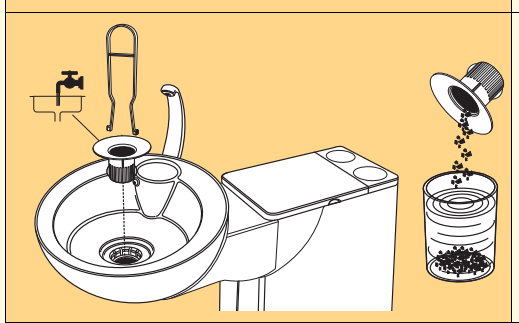

Вынуть и очистить золотоуловитель
- в обеденный перерыв
- в конце рабочего дня

Остатки амальгамы собрать в закрытую ёмкость с водой.

⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***
Остатки амальгамы не выливать в плевательницу.

Для промывки залить 1 литр воды в плевательницу.

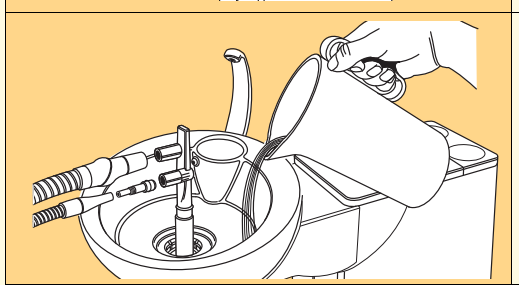

Отсосать дезинфицирующее средство
- в обеденный перерыв
- в конце рабочего дня

⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***
Используйте только средства для очистки и дезинфекции, допущенные фирмой Sirona!

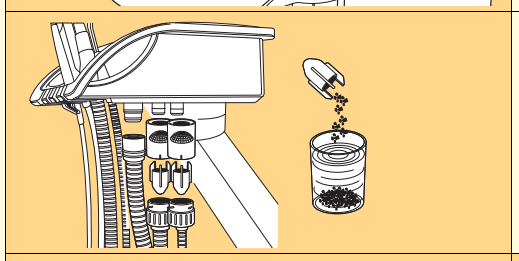

Очистить фильтр
- в конце рабочего дня

Остатки амальгамы собрать в закрытую ёмкость с водой.

⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***
Остатки амальгамы не выливать в плевательницу.

Очистить педальный переключатель

Стерилизуйте лоток под стакан
- в конце рабочего дня

⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***
Не эксплуатируйте установку без лотка под стакан.

Еженедельно

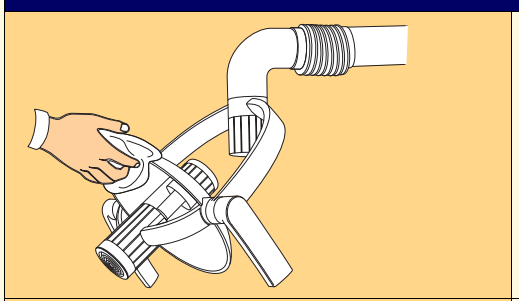

Очистить отражатель светильника аппарата

⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***
Для очистки используйте спирт 70 %!

ВНИМАНИЕ! Отражатель должен быть холодным.

Более подробную информацию по уходу и очистке светильника см. Инструкцию по эксплуатации SIROLUX FANTASTIC.

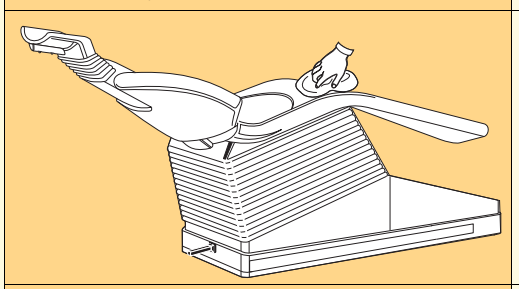

Обработать и очистить обивку

⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***
Используйте только средства для очистки и ухода, допущенные фирмой Sirona! На обивке Lounge применение чистящей губки средства FD360 запрещено.

Точно выполняйте инструкции по использованию средства для ухода.

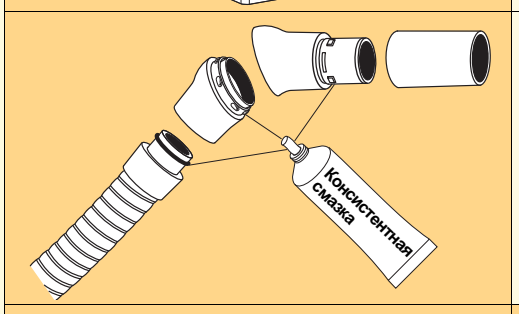

Отсасывающие прямые наконечники разъединить на шарнире, очистить и смазать точки разъема

⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***
Используйте только чистящие средства, допущенные фирмой SIRONA!

Следует вынимать и очищать трубку для наполнения стакана для полоскания рта или, при необходимости, **адаптер для гидроколлоидного охлаждения**, а также смазывать резиновые уплотнения

Плевательница
наполнение стакана для полоскания рта с сенсорной автоматикой: Очистить участок вокруг отверстий для выпуска воды

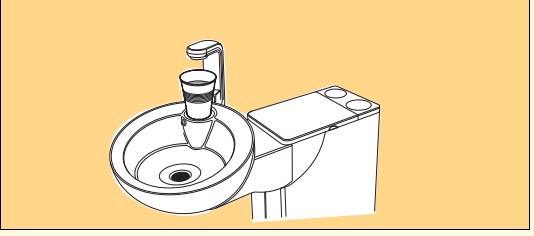

Ежемесячно или по необходимости

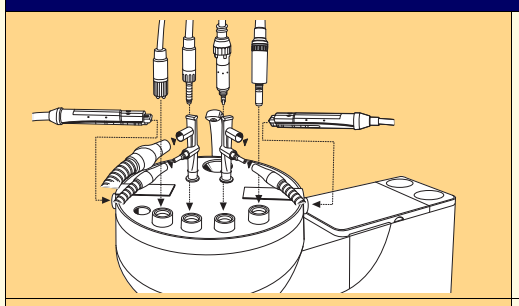

Санация
Для уменьшения биоплёни внутри водопроводящей системы стоматологической установки.

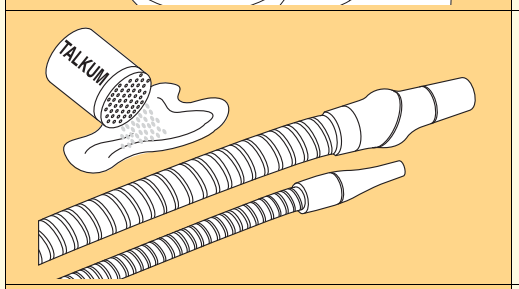

Отсасывающие шланги
В том случае, если в результате дезинфекции поверхность шлангов стала клейкой, очистить шланги средством для мытья посуды и, при необходимости, слегка натереть тальком.
Только $C3^+$, $C4^+$, $C5^+$ с магнитной меткой:
Обрабатывать эти отсасывающие шланги (твёрдый ПВХ) тальком запрещается.

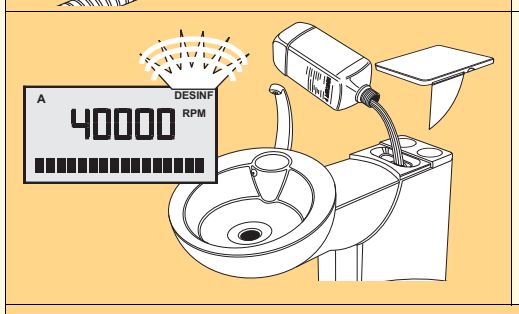

Долить средство дезинфекции воды

⚠ ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***
Используйте только чистящие средства, допущенные фирмой SIRONA!

DENTOSEPT P, 6x1 л: REF 33 18 156
в Канаде/Японии/США:
DENTOSEPT P, 6x1 л: REF 59 69 535

Заменить амальгамный ротор

1. Выполнить дезинфекцию
2. Только на включенной установке: Извлечь амальгамный ротор
3. Залить собранные остатки амальгамы, закрыть амальгамный ротор
4. Вынуть амальгамный ротор из нижней части установки отправить на утилизацию

ВНИМАНИЕ! Ротор должен быть обязательно заменён не позднее, чем через 12 месяцев!

Более подробная информация содержится в соответствующих документах „Уход и очистка силами сотрудников практики“.
В целях гигиены и дезинфекции соблюдайте национальные требования и рекомендации (например, RKI, ADA, CDC и т.д.).

D 3386.104.01.09.12 12.2015 Ä.-Nr. 120 896 Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений и возможные ошибки 62 08 719 D 3386